



空气动力学学报
Acta Aerodynamica Sinica
ISSN 0258-1825, CN 51-1192/TK

《空气动力学学报》网络首发论文

题目：卷积神经网络在风洞天平静态校准中的应用分析
作者：汪运鹏，聂少军，王粤，姜宗林
收稿日期：2022-06-01
网络首发日期：2022-07-28
引用格式：汪运鹏，聂少军，王粤，姜宗林. 卷积神经网络在风洞天平静态校准中的应用分析[J/OL]. 空气动力学学报.
<https://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1192.TK.20220727.1438.002.html>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

文章编号：0258-1825(2022)00-0001-08

卷积神经网络在风洞天平静态校准中的应用分析

汪运鹏^{1,2,*}, 聂少军^{1,2}, 王粤^{1,2}, 姜宗林^{1,2}

(1. 中国科学院力学研究所 高温气体动力学国家重点实验室, 北京 100190;

2. 中国科学院大学 工程科学学院, 北京 100049)

摘要:风洞天平是气动力试验中最重要的测量装置,用于测量作用在模型上的空气动力载荷(力与力矩)的大小、方向和作用点,而测量结果的精准度则与天平的静态校准性能直接相关。天平的静态校准就是通过校测设备建立天平测量信号与所受气动载荷的映射关系。为了减小由于受载变形产生的误差,进一步提升应变天平静态校准的性能,本文探索深度学习技术在风洞天平静态校准中的应用技术,利用中国科学院力学研究所风洞天平校准系统 AiBCS,对六分量应变天平开展基于卷积神经网络的静态校准研究,采用深度学习训练模型代替传统风洞天平校准公式并获取更高性能指标。同时,对人工智能建模方法在天平静态校准中的适用条件、有效性及可靠性等方面进行了讨论和评估分析。数据结果显示:相较于传统的基于最小二乘多项式拟合方法,卷积神经网络天平校准方法有效降低了天平各个分量间的载荷干扰,其精准度得到了较大幅度提升。

关键词:气动力测量;风洞应变天平;静态校准;深度学习;卷积神经网络

中图分类号:V211.751 文献标识码:A doi: 10.7638/kqdlxxb-2022.0096

Application analysis of convolutional neural network in static calibration of wind tunnel balance

WANG Yunpeng^{1,2,*}, NIE Shaojun^{1,2}, WANG Yue^{1,2}, JIANG Zonglin^{1,2}

(1. State Key Laboratory of High Temperature Gas Dynamics, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100090, China;

2. School of Engineering Science, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: The wind tunnel balance is the most important measuring device in aerodynamic testing, which is used to measure the magnitude, direction and point of the aerodynamic loads (forces and moments) acting on the test model. The accuracy of the measurement is directly related to the static calibration performance of the wind tunnel balance. The static calibration of the balance is the process of establishing the mapping relationship between the balance output signals and the aerodynamic loads through the calibration equipment. To reduce the error caused by load deformation and improve the performance of the static calibration of the strain-gauge balance further, this paper explored the application of deep-learning technique in the static calibration of wind tunnel balance, and used the calibration system AiBCS, which was built by Institute of Mechanics of Chinese Academy of Sciences, to carry out the research on the calibration of a strain-gauge balance based on convolutional neural networks (CNN). The purpose of this study is to use the deep-learning training model to replace the traditional balance calibration formula, in order to obtain higher measuring performance. The applicable conditions, validity and reliability of the artificial intelligence modeling in the balance calibration were discussed and evaluated. The results obtained by the CNN-based calibration method and the traditional polynomial fitting method were compared and analyzed, which shows that the CNN-based calibration method can reduce the load interference between the various components of the balance effectively, and its measuring performance was greatly improved. The cross-application of deep-learning technology and calibration of wind

收稿日期:2022-06-01; 修订日期:2022-07-13; 录用日期:2022-07-19

基金项目:国家自然科学基金(11672357,11727901)

作者简介:汪运鹏^{*}(1978-),男,副研究员,研究方向:脉冲风洞天平测力. E-mail: wangyunpeng@imech.ac.cn

引用格式:汪运鹏,聂少军,王粤,等.卷积神经网络在风洞天平静态校准中的应用分析[J].空气动力学学报,2022,40(X):1-8.

WANG Y P, NIE S J, WANG Y, et al. Application analysis of convolutional neural network in static calibration of wind tunnel balance[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2022, 40(X): 1-8(in Chinese). doi: 10.7638/kqdlxxb-2022.0096

tunnel balance has great engineering application value.

Keywords: aerodynamic measurement; wind tunnel strain-gauge balance; static calibration; deep-learning; convolutional neural network

0 引言

为进一步提高航空、航天飞行器的气动性能,需要切实提高风洞天平的性能指标和测试环境适应性。风洞天平技术需要不断得到创新发展,尤其是在天平校准方面,需要针对相关技术(安装定位、校准方法、数据采集和处理等)开展持续研究,以提高风洞天平的测量性能。风洞天平的校准可分为静态校准和动态校准,本文探讨的校准技术主要针对静态校准技术。静态校准是根据天平静态校测原理,利用天平静态校准设备(一般称为校准台或校准系统),按照静态校准方法,建立天平输出信号与所受气动力映射关系的过程,即获取天平公式和天平其他性能参数(如精度、准确度指标)的过程。由于静态校准直接决定了校测效率及天平公式的准确性,关系到风洞天平在测量应用中气动数据的精准度,所以风洞天平静态校准被认为是天平设计过程中的最重要环节^[1]。风洞天平作为一类特殊的力计量传感器,在国际上还未建立统一的标定标准^[2]。因此,同一台待校准风洞天平,当采用不同校准台和不同的校准方法进行标定时,所得到的天平公式系数存在一定差异且直接影响测力不确定度。目前普遍采用线性插值拟合的方法(如最小二乘法)获取天平公式系数^[3],但是多分量风洞天平的各个分量间存在相互干扰,并且通常二次干扰和组合干扰会出现非线性特性,采用线性拟合方法会产生一定误差^[4],使得风洞天平静态校准性能受到数据处理方法(线性拟合)局限性影响而较难进一步提高。

人工智能领域中的神经网络,因其具有很强的非线性映射及泛化功能,能较好描述非线性系统和不确定系统。早期的神经网络(如BP算法)在函数逼近、多维插值、模式识别等领域得到广泛应用^[5]。由此,一些相关拓展应用也在系统辨识、传感器非线性修正、传感器校准等方面开展了诸多探索性研究。尤其是力传感器校准方面,其输出特性大都具有非线性特征,各种环境参数影响导致存在多种误差因素。汪晓东等^[6]把BP算法用于传感器静态误差的综合修正,并论证了该神经网络方法应用的可行性。于振等^[7]设计开发了一套扭矩传感器静态校准系统,同样采用BP神经网络建立了待校准传感器测量载荷输出与底部更高精度传感器测量载荷之间的数学模型,有效提高了扭矩传感器静态校准系统的精度和可靠

性。车兵辉等^[4]采用具有6个输入节点和6个输出节点的三层BP神经网络算法对风洞天平校准数据处理开展了相关研究。该神经网络建模方法得到的结果使拟合精度平均提高超过60%,同时有效消除了系统非线性引起的误差。显然,具有较强非线性映射能力的BP神经网络在数据建模方面表现出了较好的效果。但同时注意到BP神经网络也具有一定局限性,如:由于BP神经网络在样本训练中的稳定性受到学习效率制约,导致训练效率较低;针对非线性可分问题时,BP神经网络则可能出现局部最小值,从而导致较难得到全局最优解,同时,在面对大样本数据时,均方根误差(MSE)过大使得训练过程很难收敛。事实上,目前人工智能技术依然面临着许多根本性的问题,如采用不同神经网络方法对非线性函数做拟合处理,得到结果的合理性、可靠性无法给出完备验证,对深度学习训练结果的生成逻辑和认知行为无法完全理解和解释。因此,这要求我们需要根据神经网络技术的不断创新发展,研究和验证不同网络技术手段的有效性,以满足我们现阶段的相关测试应用。近几年,随着人工智能技术在诸多领域的成功应用,深度学习方法获得了飞速发展。其中,卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)在多个领域(如图像和语言的辨识处理等)得到了空前的发展和应用。它作为一类包含卷积计算且具有深度结构的神经网络,卷积层的权值共享使网络中可训练的参数变少,降低了网络模型复杂度,较少过拟合,从而获得一个更好的泛化能力。

因此,本文在天平静态校准数据处理过程中,采用深度学习卷积神经网络方法,对多分量天平公式拟合方法进行了较为深入研究,希望通过深度学习技术的引入,探索人工智能技术在风洞天平测试领域的有效应用。

1 风洞天平传统静态校准方法与设备

从20世纪40年代开始,风洞天平静态校准从使用单分量人工加载砝码校准台发展到六分量自动校准设备(系统),已经逐步形成了当今风洞天平校准普遍采用的硬件装置和逻辑方法^[2]。

1.1 传统天平校准公式拟合方法

一台 n 分量天平安装在校准设备后,对其进行 m 组加载(通常采用砝码)后,得到一组所施加载荷和

相应的电压值输出, 设 F_{ij} ($i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$) 为加载的载荷, ΔV_{ij} ($i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$) 为输出电压值。对于一台六分量天平的校准, 取 $n = 6, m = 144$, 则有对法向力 Y 单元列出 27 个未知数的 144 个方程的线性方程组^[8]:

$$C_1^1 \times \Delta V_{1,1} + C_1^2 \times F_{1,2} + C_1^3 \times F_{1,3} + C_1^4 \times F_{1,4} + C_1^5 \times F_{1,5} + C_1^6 \times F_{1,6} + \sum_{i=1}^6 C_1^{i,i} \times F_{1,i}^2 + \sum_{i=1}^5 \sum_{j=i+1}^6 C_1^{i,j} \times F_{1,i} \times F_{1,j} = F_{1,1} \quad (1)$$

$$C_1^1 \times \Delta V_{2,1} + C_1^2 \times F_{2,2} + C_1^3 \times F_{2,3} + C_1^4 \times F_{2,4} + C_1^5 \times F_{2,5} + C_1^6 \times F_{2,6} + \sum_{i=1}^6 C_1^{i,i} \times F_{2,i}^2 + \sum_{i=1}^5 \sum_{j=i+1}^6 C_1^{i,j} \times F_{2,i} \times F_{2,j} = F_{2,1} \quad (2)$$

.....

$$C_1^1 \times \Delta V_{m,1} + C_1^2 \times F_{m,2} + C_1^3 \times F_{m,3} + C_1^4 \times F_{m,4} + C_1^5 \times F_{m,5} + C_1^6 \times F_{m,6} + \sum_{i=1}^6 C_1^{i,i} \times F_{m,i}^2 + \sum_{i=1}^5 \sum_{j=i+1}^6 C_1^{i,j} \times F_{m,i} \times F_{m,j} = F_{m,1} \quad (3)$$

同理类推, 可列出对俯仰力矩 M_z , 滚转力矩 M_x , 轴向力 X , 侧向力 Z , 偏航力矩 M_y 的线性方程组。分别对这六个线性方程组求解, 即可得到天平校准公式系数^[8]。

经分析这六个线性方程组的共同点: 均为具有 27 个未知数、144 个方程的线性方程组。方程组的个数大于未知数的个数, 超过了一般所需要的定解条件, 这类方程为超定方程, 是一个矛盾方程组。从实际出发, 我们通常采用最小二乘法求出它的最小二乘解^[9]。这便是传统天平校准过程中的数据处理方法, 显然它在一定条件要求下是行之有效的, 并解决了工程中的实际问题。

1.2 超大量程风洞天平校准系统 AiBCS

基于脉冲风洞的测力天平载荷量程特点, 中国科学院力学研究所建成了一台超大载荷风洞天平高精度全自动校准系统 (AiBCS, 见图 1)^[10]。该系统采用体轴坐标系校准方法, 即在风洞天平受载荷变形后, 可实现回零式自动补偿, 使天平恢复到初始状态, 从而保持施加力和力矩的方向始终与天平体轴坐标系保持一致。

AiBCS 设计载荷指标充分考虑了多个因素, 如高超飞行器升阻比特点、激波风洞流场起动特点^[11]等。AiBCS 校准精度指标优于 0.05%F.S., 可实现最大法向力 ± 15 kN 量程范围的脉冲型天平的高精确度“一键式”全自动校准^[10]。



图 1 AiBCS 校准系统照片

Fig. 1 The photo of AiBCS

2 神经网络方法在天平静校中应用的技术问题探讨

首先, 风洞天平校准设备按照加载坐标轴系的不同, 可分为体轴系天平校准设备和地轴系天平校准设备。对于地轴系校准台, 施加载荷的方向假设与地轴系一致, 对天平受载后产生的变形不作调整。为了提高天平静校的准确度, 一般通过测量天平受载后产生的变形量, 对施加载荷进行坐标轴系修正, 获得近似于在体轴系天平校准设备上校准天平的结果。对于体轴系校准设备而言, 其施加载荷方向始终与天平体轴系一致, 从而保证校准加载过程与实际风洞测试受载过程基本一致。因此, 相较于地轴系设备, 其具有更高的校准精准度。但体轴系校准台也大致分为两类, 即补偿型和非补偿型设备。补偿型体轴系天平校准设备结构复杂、造价高, 但是其校准得到的天平公式中, 干扰项数量明显减少, 干扰量也明显降低, 精准度提高。非补偿型校准台虽然具有设备结构简化、不需调整系统的优点, 但是该类型设备不考虑施加载荷方向随天平受载变形后的变化会引入一定误差, 相对降低了校测精准度。通过以上地轴系与体轴系设备校准差别的介绍和讨论, 显然补偿型体轴系天平校准台具有更高的校准性能。原因是天平受载变形后, 该类型设备可实时跟踪测量变形量大小并换算复位量, 使得施加载荷方向与天平体轴系一致, 即其可自动调整加载系统保证天平加载状态不变^[8]。

其次, 天平系统刚度不足等因素会增加非线性交叉项干扰, 使得天平校准复杂化, 传统的多项式拟合方法无法处理这种非线性干扰^[12]。神经网络方法是一种模拟人脑的神经网络, 以期能够实现类人工智能的机器学习技术。目前已经在诸多领域开展了广泛的应用研究, 包括风洞测试中测力天平技术的智能化探索等^[13]。神经网络建模方法的优点是可以更好的消除天平分量间非线性干扰引起的误差。将神经网络模型 (如人工神经网络、卷积神经网络等) 应用于天平静态校准数据处理, 主要是通过对加载数据开

展训练建模,得到校准模型,代替基于最小二乘多项式拟合方法得到的传统天平校准公式。

但同时注意到,神经网络方法是对一组输入信号和一组输出信号之间的映射关系进行建模,通过调整内部大量节点(神经元)之间相互连接的权重,从而达到处理信息的目的。作为一种黑箱方法,它不会给出模型处理过程和内部解算机制,这意味着如果天平校准状态(加载过程)与天平使用状态(应用受载过程)不一致,那么由于不一致而产生的误差将被无条件的作为“有效”信息增加到训练模型中。因此,我们前面讨论的地轴系设备运行中,如果采用神经网络方法对校准数据进行处理建模,那么加载载荷方向与天平体轴系的不一致问题所导致的误差量将被包含在建模信息中处理。早期部分天平校准台不具备天平校准回零功能,国内外一些技术人员也采用了一些修正措施^[14-15],因此一些地轴系天平校准台也可实现体轴系静态校准,但前提条件是对校准结果要进行准确评估并满足使用要求。

综上所述,针对神经网络方法在天平静态校准中的有效应用,天平建模所需样本数据应满足施加载荷方向与天平体轴坐标系一致的条件。

3 基于 CNN 的天平校准数据处理方法

3.1 卷积神经网络

对于一般的人工智能任务而言,提取特征是其中重要且困难的关键步骤。传统的机器学习算法通过人工的方式设计有效的特征集合,当问题比较复杂时,需要花费研究人员大量的时间和精力,而且实际问题中的不确定因素会导致提取的特征效果不理想,甚至无法有效提取特征。相比于传统的机器学习算法,深度学习算法会自动提取问题的简单特征,通过学习特征与任务之间的关联,逐渐将各层简单特征组合成能反映任务的复杂特征,从而使整个问题变得简单且有效。深度学习由于其学习和适应能力强、可移植性好且所需样本量小等优点,在诸多领域有着非常广泛的应用,如计算机视觉、语音识别和自然语言处理等^[16]。

神经网络结构是深度学习中至关重要的部分,对神经网络模型的准确率会产生巨大的影响。CNN 是深度学习中常用的一种神经网络结构,常用于解决图像识别和回归预测等问题。

在对天平进行静态校准的过程中,天平测量输出信号与气动载荷信号具有一一映射关系,即当天平的输出值确定时,其对应的载荷值也随之确定。天平的输出信号与载荷的关系本质上是回归预测问题。

CNN 在处理空间信息中具有独特的优势,在对样本数据进行监督学习后可以自动地提取天平输出信号中的关键特征,通过不断训练完成从天平输出信号到载荷信号的拟合,从而预测天平输出的载荷信号。故本研究采用基于 CNN 的智能模型对天平进行静态校准训练,从而获得天平精准度和不确定度等校准性能指标。

3.2 CNN 校准模型的构建

针对一台六分量杆式应变天平在 AiBCS 测量中输出的电压值和载荷值,构建风洞天平静态校准数据的 CNN 校准模型。在构建模型之前需要采集适量的样本,包括训练样本、验证样本和测试样本,三者其特征上应该尽可能保持一致。首先在 AiBCS 上采集 144 组样本,将样本集随机划分为训练样本集和验证样本集,其中 80% 的样本作为训练样本,用于更新网络参数,剩余 20% 的样本作为验证样本用于进一步优化网络参数。在 CNN 校准模型构建完成之后,在 AiBCS 上采集适量样本作为测试样本用于校准数据分析,主要包括精度、误差以及不确定度分析。

3.2.1 卷积网络结构

CNN 校准模型包括输入层、卷积层和输出层,输入层是六分量的天平电压值和对应的载荷值;卷积层是 CNN 校准模型中的核心层,其数目和大小会影响模型的训练结果,采用一维卷积函数;输出层是六分量天平的载荷预测值。

在 CNN 校准模型的训练过程中,常用损失函数(loss)衡量网络模型的质量,随着训练轮数的增加,不断降低损失函数的值,以更新网络参数,从而使模型达到收敛状态。CNN 校准模型采用均方误差(mean square error, MSE)函数作为损失函数,MSE 是反映模型的目标值与输出预测值的离散程度。其值越小,说明模型输出值与真实值越接近,模型质量越好。MSE 的计算公式为

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (4)$$

式中, N 是样本总数, y_i 和 \hat{y}_i 分别是第 i 组样本的真实值与预测值。

CNN 校准模型训练流程如图 2 所示。首先将训练样本集中天平输出的电压值和对应的载荷值作为输入层,然后通过卷积层更新模型的网络参数,当损失函数和训练轮数满足要求后,输出天平的载荷预测值,即完成 CNN 校准模型的训练。

3.2.2 参数优化问题

在确定 CNN 校准模型的结构之后,需要通过验

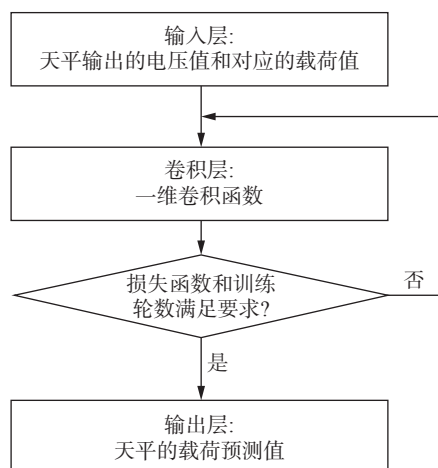


图 2 CNN 校准模型训练流程图

Fig. 2 Flow chart of the CNN calibration model

证集进一步优化神经网络参数,一般针对训练轮数和卷积层数对 CNN 校准模型进行优化。优化目标是在保证模型精准度足够高的情况下,尽可能减少模型的训练时间,节省计算成本。经过分析,本文天平静校案例中的初始参数设定如下:卷积层数为 4,学习率为 10^{-5} ,训练轮数为 10000。

当其他参数不变时,一定程度上,随着训练轮数的增加,模型的损失函数会降低,训练结果的精准度会相应提高,同时计算时间也会相应增加。表 1 展示的是训练轮数分别是 10000、50000 和 100000 时的验证样本集的损失函数值。当训练轮数是 10000 时,损失函数的值由初始的 10^3 量级降低到 10^2 量级;当训练轮数增加到 50000 时,损失函数的值降低到 10^{-2} 量级;继续增加训练轮数至 100000,此时的损失函数稳定在 10^{-2} 量级保持不变,但计算时间明显增加,说明在一定范围内,增加训练轮数可以有效降低损失函数值。因此,综合损失函数值与计算时间,选取训练轮数为 50000。

表 1 不同训练轮数的 CNN 校准模型的 loss 对比

Table 1 Loss of CNN calibration model with different epochs

训练轮数	初始loss	终止loss
10000	2.74×10^3	1.14×10^2
50000	2.74×10^3	3.72×10^{-2}
100000	2.74×10^3	4.75×10^{-2}

在确定训练轮数之后,研究卷积层数对模型训练结果的影响,通过比较验证样本集的损失函数值来优化模型参数。在卷积层数是 4 的基础上,分别增加卷积层数至 8 和 12,将损失函数值整理至表 2 中。由表 2 中的数据可知,当训练轮数为 50000 时,卷积层数为 4、8 和 12 的 CNN 校准模型的最终损失函数值

均能由 10^3 量级降低到 10^{-2} 量级,并且最终保持稳定趋势。随着卷积层数的增加,模型结构更加复杂,相应的计算时间也会增加,因此,综合选取卷积层数为 4 层。

表 2 不同卷积层数的 CNN 校准模型的 loss 对比

Table 2 Loss of CNN calibration model with different convolutional layers

卷积层数	初始loss	终止loss
4	2.74×10^3	3.72×10^{-2}
8	2.74×10^3	5.69×10^{-2}
12	2.75×10^3	4.63×10^{-2}

综上所述,在保证最终损失函数值足够小且稳定的情况下,尽可能缩短计算时间,优化后的 CNN 智能模型的卷积层数为 4,训练轮数为 50000,学习率为 10^{-5} 。

3.3 天平校准数据精准度分析

在确定 CNN 校准模型的结构参数和训练参数之后,为了进一步评估训练轮数对训练结果的影响,随机选取验证样本集中的一组数据进行相对误差分析,以天平输出电压值对应的载荷值为真实值 F ,CNN 校准模型输出的天平载荷值为预测值 \hat{F} ,计算两者的相对误差 δ ,计算公式为

$$\delta = \frac{\hat{F} - F}{F} \times 100\% \quad (5)$$

表 3 展示的是卷积层数为 4,采用不同训练轮数时,CNN 校准模型的相对误差的计算结果。由表中的数据得知,当训练轮数为 10000 时,相对误差值比较大,甚至出现了错误情况;增加训练轮数至 50000 时,天平各分量的相对误差明显降低,基本在 1% 量级;而训练轮数为 50000 和 100000 时,两者的相对误差比较相近,此时继续增加训练轮数并不能提升模型的精准度。

表 3 不同训练轮数的 CNN 校准模型的相对误差 (%) 对比

Table 3 Relative error (%) of CNN calibration model with different epochs

分量\训练轮数	10000	50000	100000
Y	4.06	-0.03	-0.04
M_z	-25.89	-0.89	1.79
M_x	-64.00	-2.50	-3.00
X	-19.42	0.79	0.90
Z	-34.55	0.60	0.60
M_y	-182.43	0.91	-0.54

表 4 展示的是训练轮数为 50000,采用不同卷积层数时,CNN 校准模型的相对误差的计算结果。由

表中数据可以得出,当卷积层数由4增加至8和12时,天平各分量的相对误差并没有明显的降低,反而出现了增加的趋势。因此,综合选取训练轮数为50000,卷积层数为4,此时CNN校准模型的天平各分量的相对误差基本控制在1%以内,具有较高的精度,且需要的计算时间相对较少,验证了该CNN校准模型的可行性,为将该方法应用于天平静态校准提供了可靠的数据支撑。

表4 不同卷积层数的CNN校准模型的相对误差(%)对比
Table 4 Relative error (%) of CNN calibration model with different convolutional layers

分量\卷积层数	4	8	12
Y	-0.03	-0.07	-0.10
M_z	-0.89	0.89	1.34
M_x	-2.50	-4.00	-3.50
X	0.79	0.81	0.92
Z	0.60	0.85	0.73
M_y	0.91	0.95	1.09

4 天平校准应用及数据精度分析

4.1 天平静态校准综合加载误差和精度

本文针对一台脉冲型六分量杆式应变天平(简称“S01-2天平”,见图3)开展了静态校准应用与性能评估。该天平被作为常规测力天平应用于JF-12激波风洞气动力测量试验,其设计载荷指标见表5。

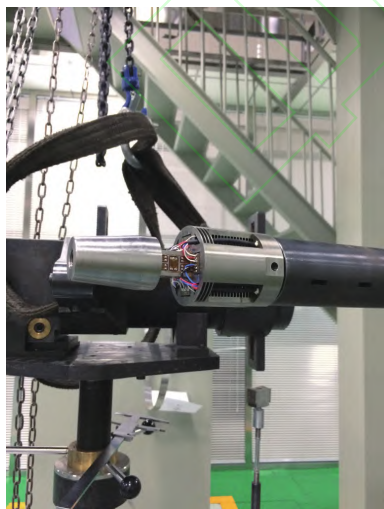


图3 六分量脉冲型应变天平

Fig. 3 The six-component pulse-type strain-gauge balance

采用CNN训练的模型对天平训练样本进行处理,经过分析发现,处理后的天平各分量载荷与电压信号对应的真实载荷值之间的相对误差非常小,精度较高。因此,尝试将该CNN校准模型应用于天平

测试样本,针对S01-2天平在AiBCS中采集适量测试样本,采用已优化的CNN校准模型对测试样本进行处理,对天平静态校准综合加载误差和加载重复性等指标进行分析。

表5 天平S01-2设计载荷
Table 5 Design load of balance S01-2

分量	设计载荷
Y	5000 N
M_z	200 N·m
M_x	50 N·m
X	2000 N
Z	2000 N
M_y	100 N·m

本文中的综合加载误差是指经过CNN校准模型处理后,输出的载荷值(近似值)与所施加的载荷值(真实值)之间的标准偏差,该指标反映了测量过程中的系统误差。在实际操作中,采用CNN校准模型对获得的天平输出电压信号进行处理,将得到的处理结果与实际载荷值进行对比,计算得到天平综合加载误差,结果整理至表6中。天平综合加载误差计算公式为

$$W_i = \frac{1}{P_{\max, i} \sqrt{m-1}} \times \sqrt{\sum_{j=1}^m (F_{ij} - P_{ij})^2} \times 100\% \quad (i = 1, 2, \dots, 6; j = 1, 2, \dots, m) \quad (6)$$

式中, W 表示天平综合加载误差; P_{\max} 表示最大设计载荷; F 和 P 分别表示近似载荷值和真实载荷值; m 表示各分量载荷的总组数;下标 i 和 j 分别表示第 i 分量和第 j 组施加载荷。

表6 天平综合加载误差(%FS)
Table 6 Balance combining loading error(%FS)

分量	天平校准公式	CNN校准模型	国军标合格指标	国军标先进指标
Y	0.05	0.015	0.4	0.1
M_z	0.11	0.047	0.4	0.1
M_x	0.21	0.157	0.5	0.2
X	0.02	0.017	0.5	0.2
Z	0.04	0.024	0.4	0.1
M_y	0.24	0.067	0.4	0.1

表6中展示了经过传统天平校准公式和CNN校准模型处理后的天平综合加载误差,并与国军标先进指标^[9]进行了对比。可以发现,同一设备和仪器条件下,CNN校准方法使得加载误差大幅度降低,最大降幅超过70%且基本达到了国军标先进指标要求。

此外,在相同的加载条件下,根据天平各个分量的设计载荷,对天平进行重复性加载,以评估测量过程中的随机误差。用于天平各分量的综合加载重复性计算的公式为

$$S_i = \frac{1}{X_{\max, i}} \times \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(X_{ij} - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_{ij} \right)^2} \times 100\% \quad (i = 1, 2, \dots, 6; j = 1, 2, \dots, n) \quad (7)$$

式中, S 表示天平的综合加载重复性; X 和 X_{\max} 分别表示天平输出载荷值和最大设计载荷; n 表示对天平分量重复性加载的次数; 下标 i 和 j 分别表示第 i 分量和第 j 次重复加载。

表 7 为传统天平校准方法与 CNN 校准方法所得结果的对比。目前的 CNN 校准模型处理得到的数据重复性指标更优,精度得到了较大幅度的提升,达到了国军标的先进指标要求。

表 7 天平综合加载重复性 (%FS)
Table 7 Balance combining loading repeatability (%FS)

分量	天平校准公式	CNN校准模型	国军标合格指标	国军标先进指标
Y	0.02	0.037	0.2	0.06
M_z	0.02	0.013	0.2	0.06
M_x	0.04	0.025	0.3	0.1
X	0.03	0.009	0.3	0.1
Z	0.02	0.016	0.2	0.06
M_y	0.14	0.041	0.2	0.06

4.2 不确定度分析

本文对天平静态校准的不确定度进行了分析,评估校准模型得到的结果与真实载荷值之间的接近程度,同时反映测量过程中的系统误差和随机误差。

表 8 为传统天平公式和 CNN 校准模型的不确定度对比数据,其中 k 表示置信水平为 95% 时的包含因子。天平校准公式和 CNN 校准模型的 B 类不确定度(主要包括载荷源不确定度、数据采集系统引入的不

表 8 天平扩展不确定度 ($k=2$) (%FS)
Table 8 Balance expanded measurement uncertainty ($k=2$) (%FS)

分量	天平校准公式	CNN校准模型	国军标合格指标	国军标先进指标
Y	1.0	0.26	1.0	0.3
M_z	0.98	0.27	1.0	0.3
M_x	1.74	0.78	1.2	0.5
X	0.51	0.47	1.2	0.5
Z	0.87	0.27	1.0	0.3
M_y	1.0	0.29	1.0	0.3

确定度和校准设备引入的不确定度)保持一致,其差别主要体现在 A 类不确定度(主要包括天平综合加载误差和天平综合加载重复性)中。CNN 校准模型获得的不确定度远小于天平校准公式计算得到的不确定度。基于 CNN 建模的静态校准性能较传统天平公式法得到了较大幅度的提升。

5 结论与展望

为了进一步提升应变天平静态校准性能,本文探索采用 CNN 对天平校准数据进行深度学习建模处理。在引入 CNN 技术之前,对神经网络技术(包括 BP 神经网络、CNN 等)在风洞天平静态校准中应用的适用性条件进行了讨论。为确保天平静态校准性能,天平校准施加载荷方向应与天平体轴坐标系一致,以减小由于受载变形导致的误差。因此,采用具有体轴校准且自动复位功能的校准设备,并对采集样本数据进行 CNN 方法建模,可大大提高校准性能。

采用 CNN 训练的校准模型实现了天平电压输出与所受载荷的高精度映射关系。数据结果显示:相较传统公式法,综合加载误差、重复性及不确定度三项指标最大降幅达到或超过 70%。CNN 校准模型对天平输出信号高阶非线性干扰的处理优于传统方法,有效降低了各个分量间的载荷干扰,体现了 CNN 在天平静态校准中的有效性。人工智能深度学习技术与风洞天平校准的交叉应用具有较大的工程推广应用价值和广泛的发展前景。

参 考 文 献:

- [1] 战培国. 国外风洞天平技术研究进展[J]. 飞航导弹, 2018(10): 63-68. doi: 10.16338/j.issn.1009-1319.20180123
- [2] 战培国. 国外风洞天平校准技术研究进展[J]. 航空科学技术, 2012, 23(2): 18-20. ZHAN P G. Development of wind tunnel balance calibration techniques[J]. Aeronautical Science & Technology, 2012, 23(2): 18-20 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1007-5453.2012.02.007
- [3] 武家驹. 应变天平多元校中几种数据处理方法的比较[J]. 气动实验与测量控制, 1994, 8(3): 55-58.
- [4] 车兵辉, 尹欣繁, 彭先敏, 等. 基于BP神经网络的天平校准数据处理方法研究[J]. 计算机测量与控制, 2020, 28(10): 165-169. CHE B H, YIN X F, PENG X M, et al. Research on data processing method of balance calibration based on BP neural network[J]. Computer Measurement & Control, 2020, 28(10): 165-169 (in Chinese). doi: 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2020.10.034
- [5] 郭利辉, 周雅. 基于MATLAB神经网络工具箱的BP网络设计[J]. 信息技术与信息化, 2009(3): 20-22. GUO L H, ZHOU Y. The design of BP neural network based on MATLAB toolbox[J]. Information Technology and Informatization, 2009(3): 20-22 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1672-9528.2009.03.006
- [6] 汪晓东, 万旭, 赵鹏程, 王骥程. 基于神经网络的传感器静态误差综合

- 修正法[J]. 仪器仪表学报, 1997, 18(3): 310-313.
doi: 10.19650/j.cnki.cjsi.1997.03.018
- [7] 于振, 于万成. 一种基于BP神经网络的扭矩传感器静态校准系统[J]. 传感技术学报, 2020, 33(2): 238-244.
YU Z, YU W C. A static calibration system of torque sensor based on BP neural network[J]. Chinese Journal of Sensors and Actuators, 2020, 33(2): 238-244 (in Chinese).
doi: 10.3969/j.issn.1004-1699.2020.02.013
- [8] 贺德馨. 风洞天平[M]. 北京: 国防工业出版社, 2001.
- [9] 中国人民解放军总装备部. 风洞应变天平规范[S]. GJB 2244A—2011.
- [10] 汪运鹏, 李小刚, 姜宗林. 脉冲型天平高精度全自动校准系统[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学, 2020, 50(6): 064702.
WANG Y P, LI X G, JIANG Z L. High-accuracy fully automatic calibration system for impulse balance[J]. Scientia Sinica (Physica, Mechanica & Astronomica), 2020, 50(6): 064702 (in Chinese).
doi: 10.1360/SSPMA-2019-0357
- [11] WANG Y P, HU Z M, LIU Y F, et al. Starting process in a large-scale shock tunnel[J]. AIAA Journal, 2016, 54(4): 1240-1249.
doi: 10.2514/1.J054145
- [12] 闫万方, 张晨凯, 蒋坤, 等. 风洞分布式支撑天平测力试验技术研究[J]. 航空工程进展, 2021, 12(6): 101-109.
YAN W F, ZHANG C K, JIANG K, et al. Experimental investigation on technology of force measurement using a distributed-sting-balance in wind tunnel[J]. Advances in Aeronautical Science and Engineering, 2021, 12(6): 101-109 (in Chinese).
doi: 10.16615/j.cnki.1674-8190.2021.06.12
- [13] 汪运鹏, 杨瑞鑫, 聂少军, 等. 基于深度学习技术的激波风洞智能测力系统研究[J]. 力学学报, 2020, 52(5): 1304-1313.
WANG Y P, YANG R X, NIE S J, et al. Deep-learning-based intelligent force measurement system using in a shock tunnel[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2020, 52(5): 1304-1313 (in Chinese).
doi: 10.6052/0459-1879-20-190
- [14] HANG B, JOHNSON I. An investigation of method on strain gauge wind tunnel balance calibration for a rig without repositioning, part I: deduction of algorithms for component corrections[R]. FFA TN 1988-06, 1988.
- [15] HANG B, JOHNSON I. An investigation on methods of wind tunnel balance calibration for a rig without repositioning after loading, part II: comparison of three methods using measured data[R]. FFA TN 1988-14, 1988.
- [16] 郑泽宇, 梁博文, 顾思宇. TensorFlow: 实战Google深度学习框架[M]. 第2版. 北京: 电子工业出版社, 2018.

(本文责编: 王颖)